


## 艾可蓝ACTNOx2.0空气辅助 集成DCU SCR后处理

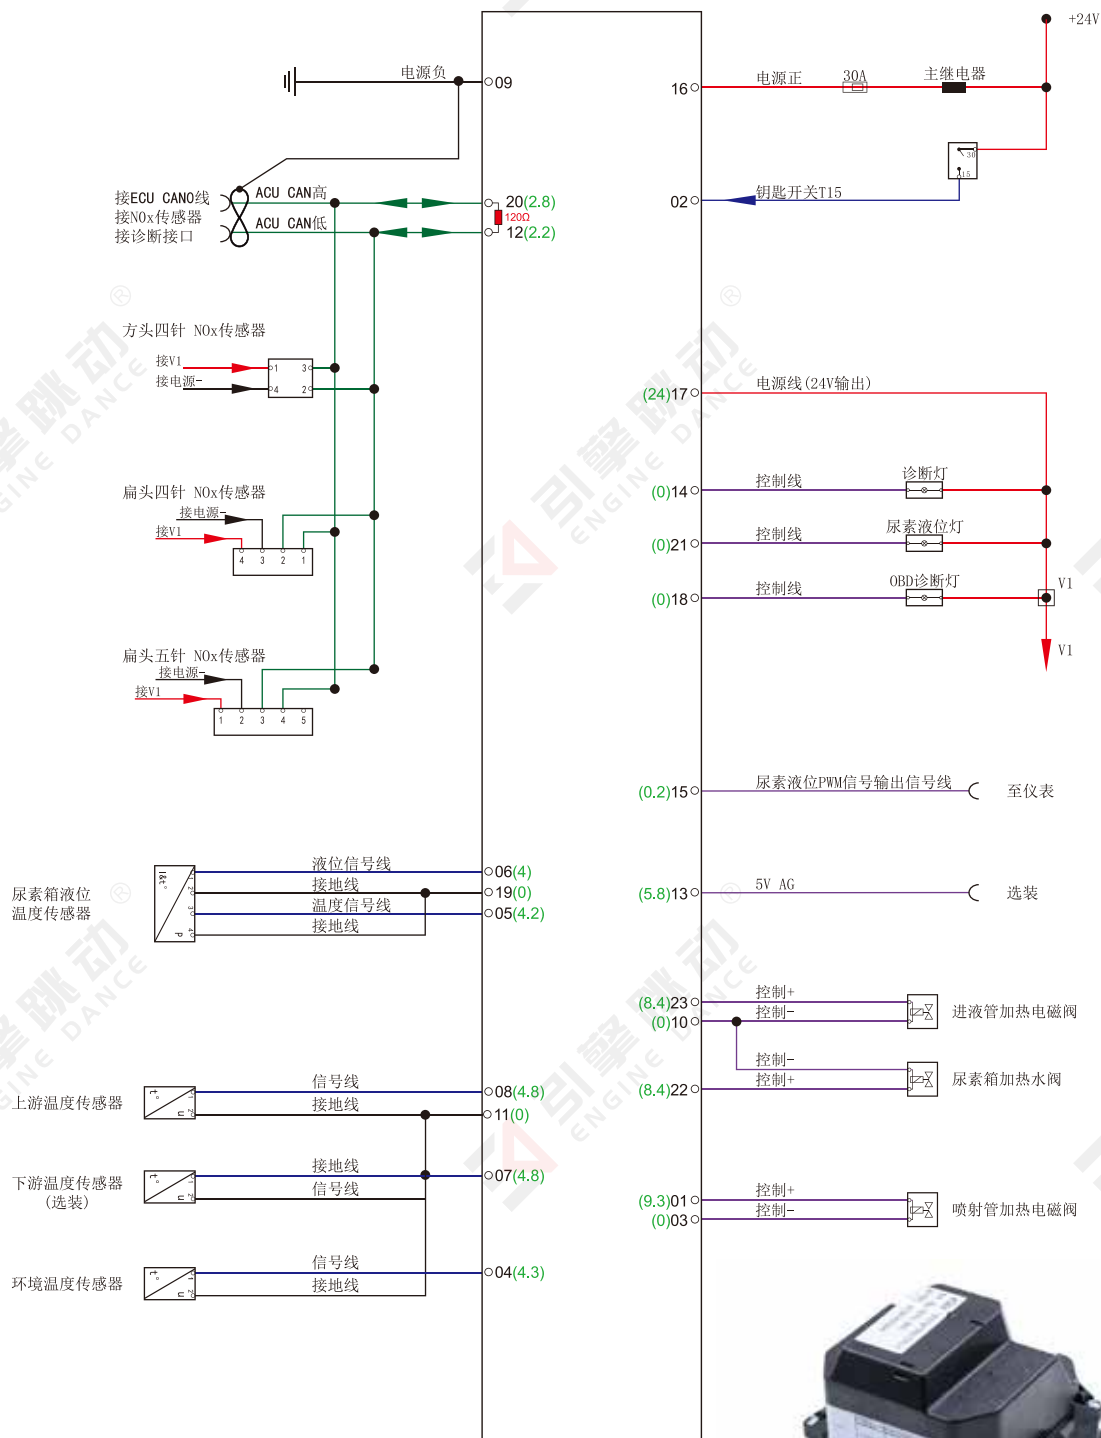

1. 如需单独给DCU上电, 需要给16接24V电源, 09接电源负极, T15端子02接24V电源。
2. 如诊断仪无法连接, 可尝试跳线: 诊断仪供电以及搭铁线连接好, 从DCU上CAN线12/20单独线接入诊断仪诊断口对应针脚。