


凯龙圆头 气助 外置DCU

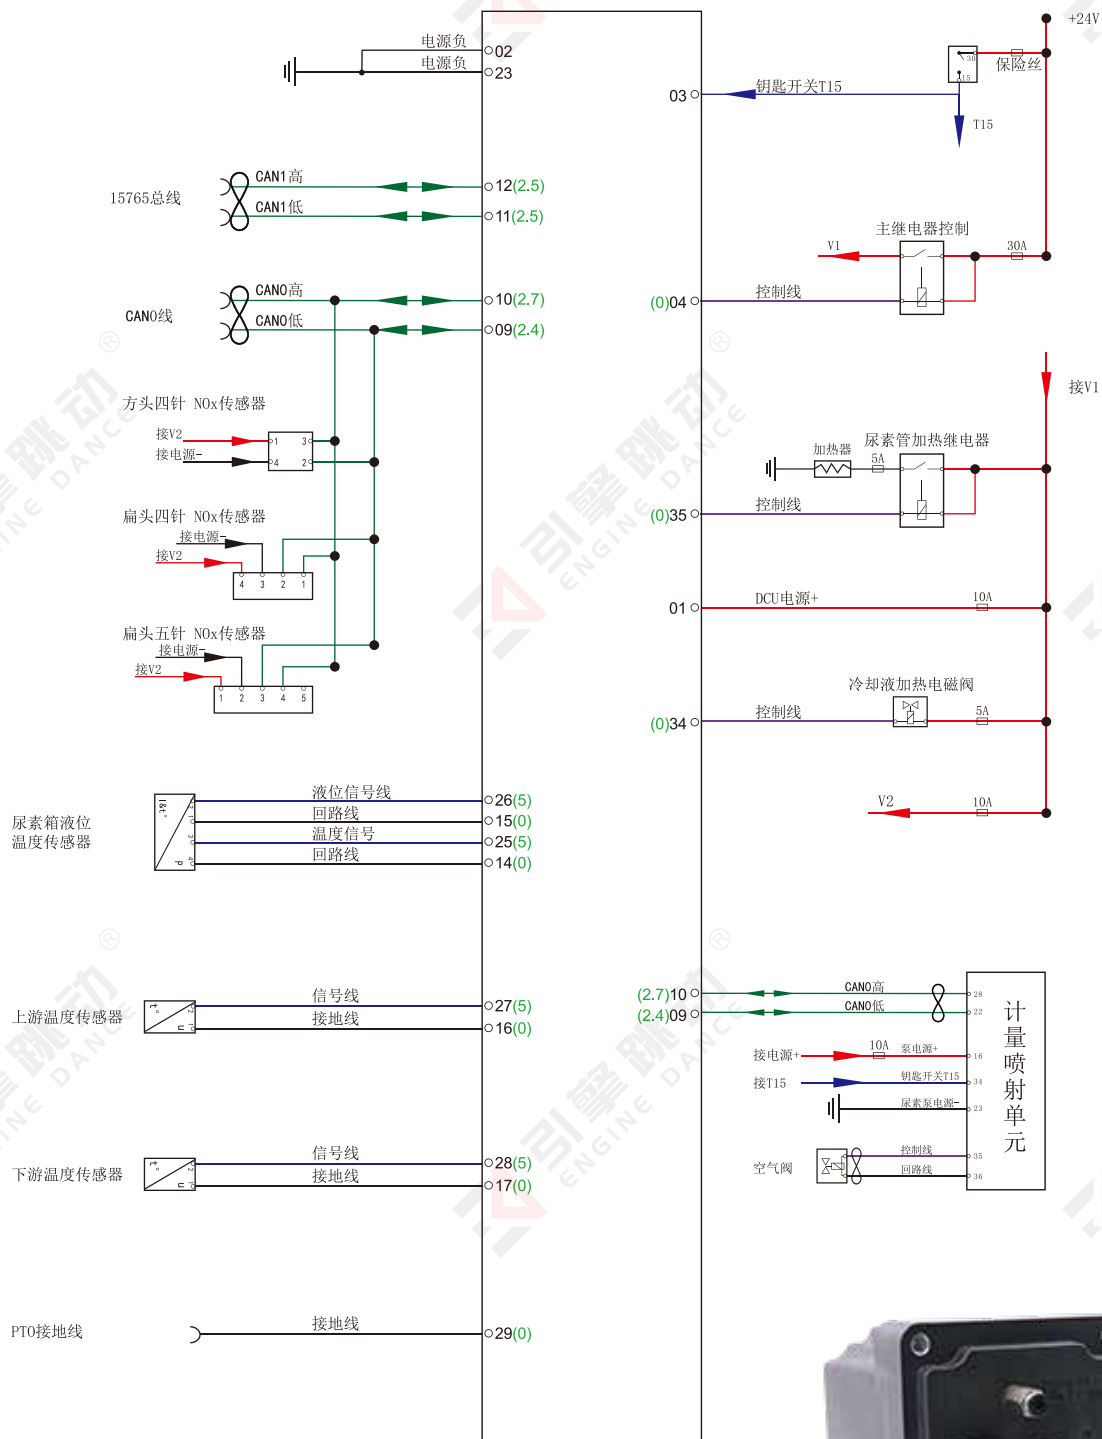

1. 如需单独给DCU上电，需要给01接24V电源，02接电源负极，T15端子03接24V电源。
2. 如诊断仪无法连接，可尝试跳线：诊断仪供电以及搭铁线连接好，从DCU上CAN线11/12（或者09/10）单独线接入诊断仪诊断口对应针脚。